PARAMOUNT BED

取扱説明書

7K00150000A6

KQ-903,913,923,933
在宅ケアベッド アウラ21
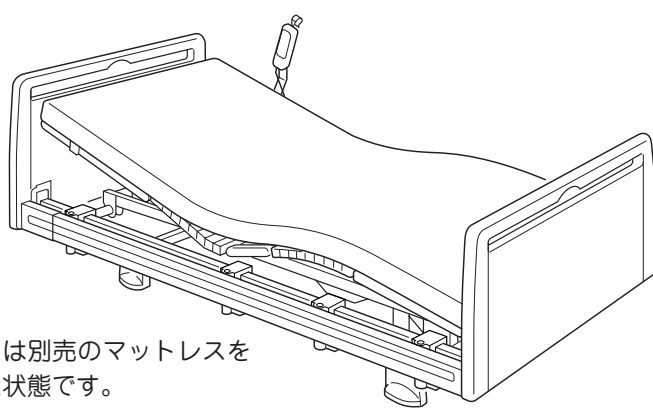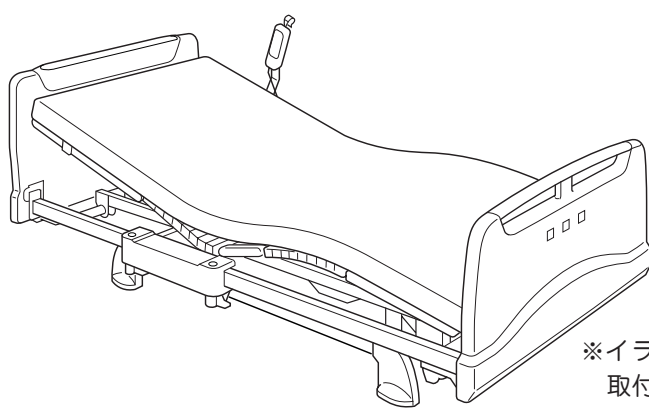
※イラストは別売のマットレスを
取付けた状態です。

まえがき

このたびは、**在宅ケアベッド・アウラ21**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、ベッドを安全にお使いいただくための注意事項、組立・分解の方法や使用方法などを記載しています。

- **ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。**
- ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社まで、お問い合わせください。

パラマウントベッド株式会社

1.背さげのしかた

■アウラ21は、停電時やベッドの故障により背ボトムがさげられなくなった場合、手動で背ボトムをさげることができます。
背さげ操作は、以下の手順で行ってください。
停電以外の理由で背ボトムがさげられなくなった場合、43ページ「故障かな？と思ったら」に従ってチェックを行ない、ベッドが故障している場合には、販売店もしくは弊社コールセンター（54ページ参照）までご連絡ください。

注記！

●作業は必ず2人以上で行なってください。
●手や腕をはさまれないように注意して行ってください。
●手動による膝さげ、高さ調節はできません。

使用する工具	ペンチもしくはプライヤー／ドライバー

❶コンセントからベッドの電源プラグを抜いてください。
❷療養している方と寝具をベッドから降ろしてください。
❸ヘッドボードを取外し、作業しやすくしてください。
❹背ボトムを押さえてください。
❺連結ピン小についているスナップピンを取外してください。
❻連結ピン小を取外してください。連結ピン小を取外すと背ボトムが自由に動くようになります。
❼背ボトムを手で支えながら降ろしてください。
❽ヘッドボードを取付けてください。
❾寝具と療養している方をベッドに戻してください。

注記！

●外した連結ピン小およびスナップピンは復帰の際に使用します。紛失しないよう、保管してください。
●この作業を行ったときは、復帰作業を行なってもとの状態にもどすまで、電源プラグはコンセントから抜いたままにしてください。

■スナップピンの抜き方

●ペンチやプライヤーで、はさんで引くか、もしくは、ドライバーの先でこじると取外しが容易です。

❼

2.戻しかた
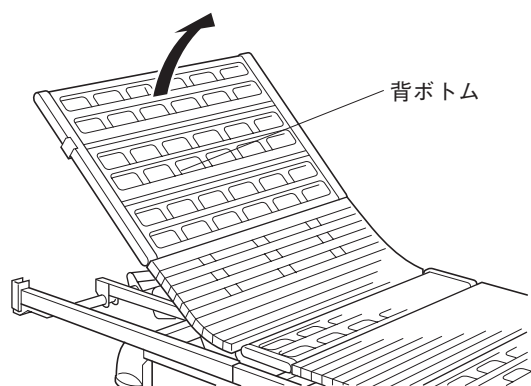
■停電の時には、電源が回復した後に、以下の手順でベッドを元の状態に戻し、32〜33ページ「組立後の点検」に従い点検を行なってください。

●作業は必ず2人以上で行なってください。
●手や腕をはさまないように注意して行ってください。

使用する部品	外した連結ピン小、 スナップピン各1本
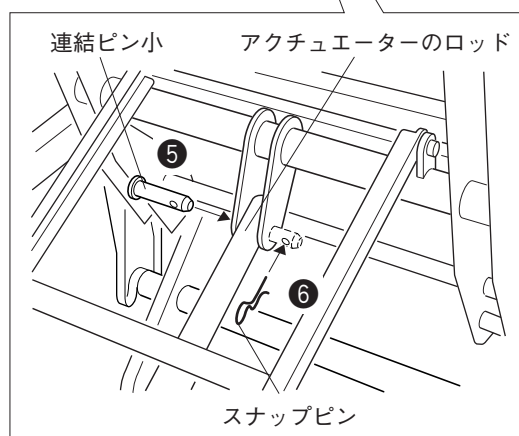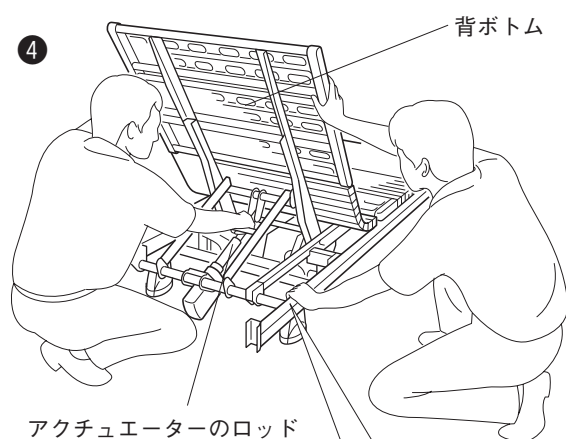
❶コンセントからベッドの電源プラグを抜いてください。
❷療養している方と寝具をベッドから降ろしてください。
❸ヘッドボードを取外し、作業しやすくしてください。
❹背ボトムとアクチュエーターのロッドを持あげ、支えてください。
❺外してあった連結ピン小を差込んでください。
❻連結ピン小が抜けないようにスナップピンを差込んでください。
❼ベッドの電源プラグをコンセントに差込んでください。
❽手元スイッチを操作して背ボトムを一番下までさげてください。
❾ヘッドボードを取付けてください。
❿寝具と療養している方をベッドに戻してください。